


A. Uchwyt sondy gazu dla analizatora GA-12^{plus}

Uchwyty sond dla analizatora GA-12^{plus} posiadają cieńszy wężyk gazu (średnica wewnętrzna 3.25mm) i 4-pinowe złącze elektryczne typu Binder 712. Złącze elektryczne nie posiada wbudowanego sensora temperatury zewnętrznej. Wąż nie posiada szybkozłączki mocującej do analizatora. W wypadku wystąpienia wersji z wbudowanym filtrem szeregowym polecane jest użycie filtra o wielkości porów 5µm.

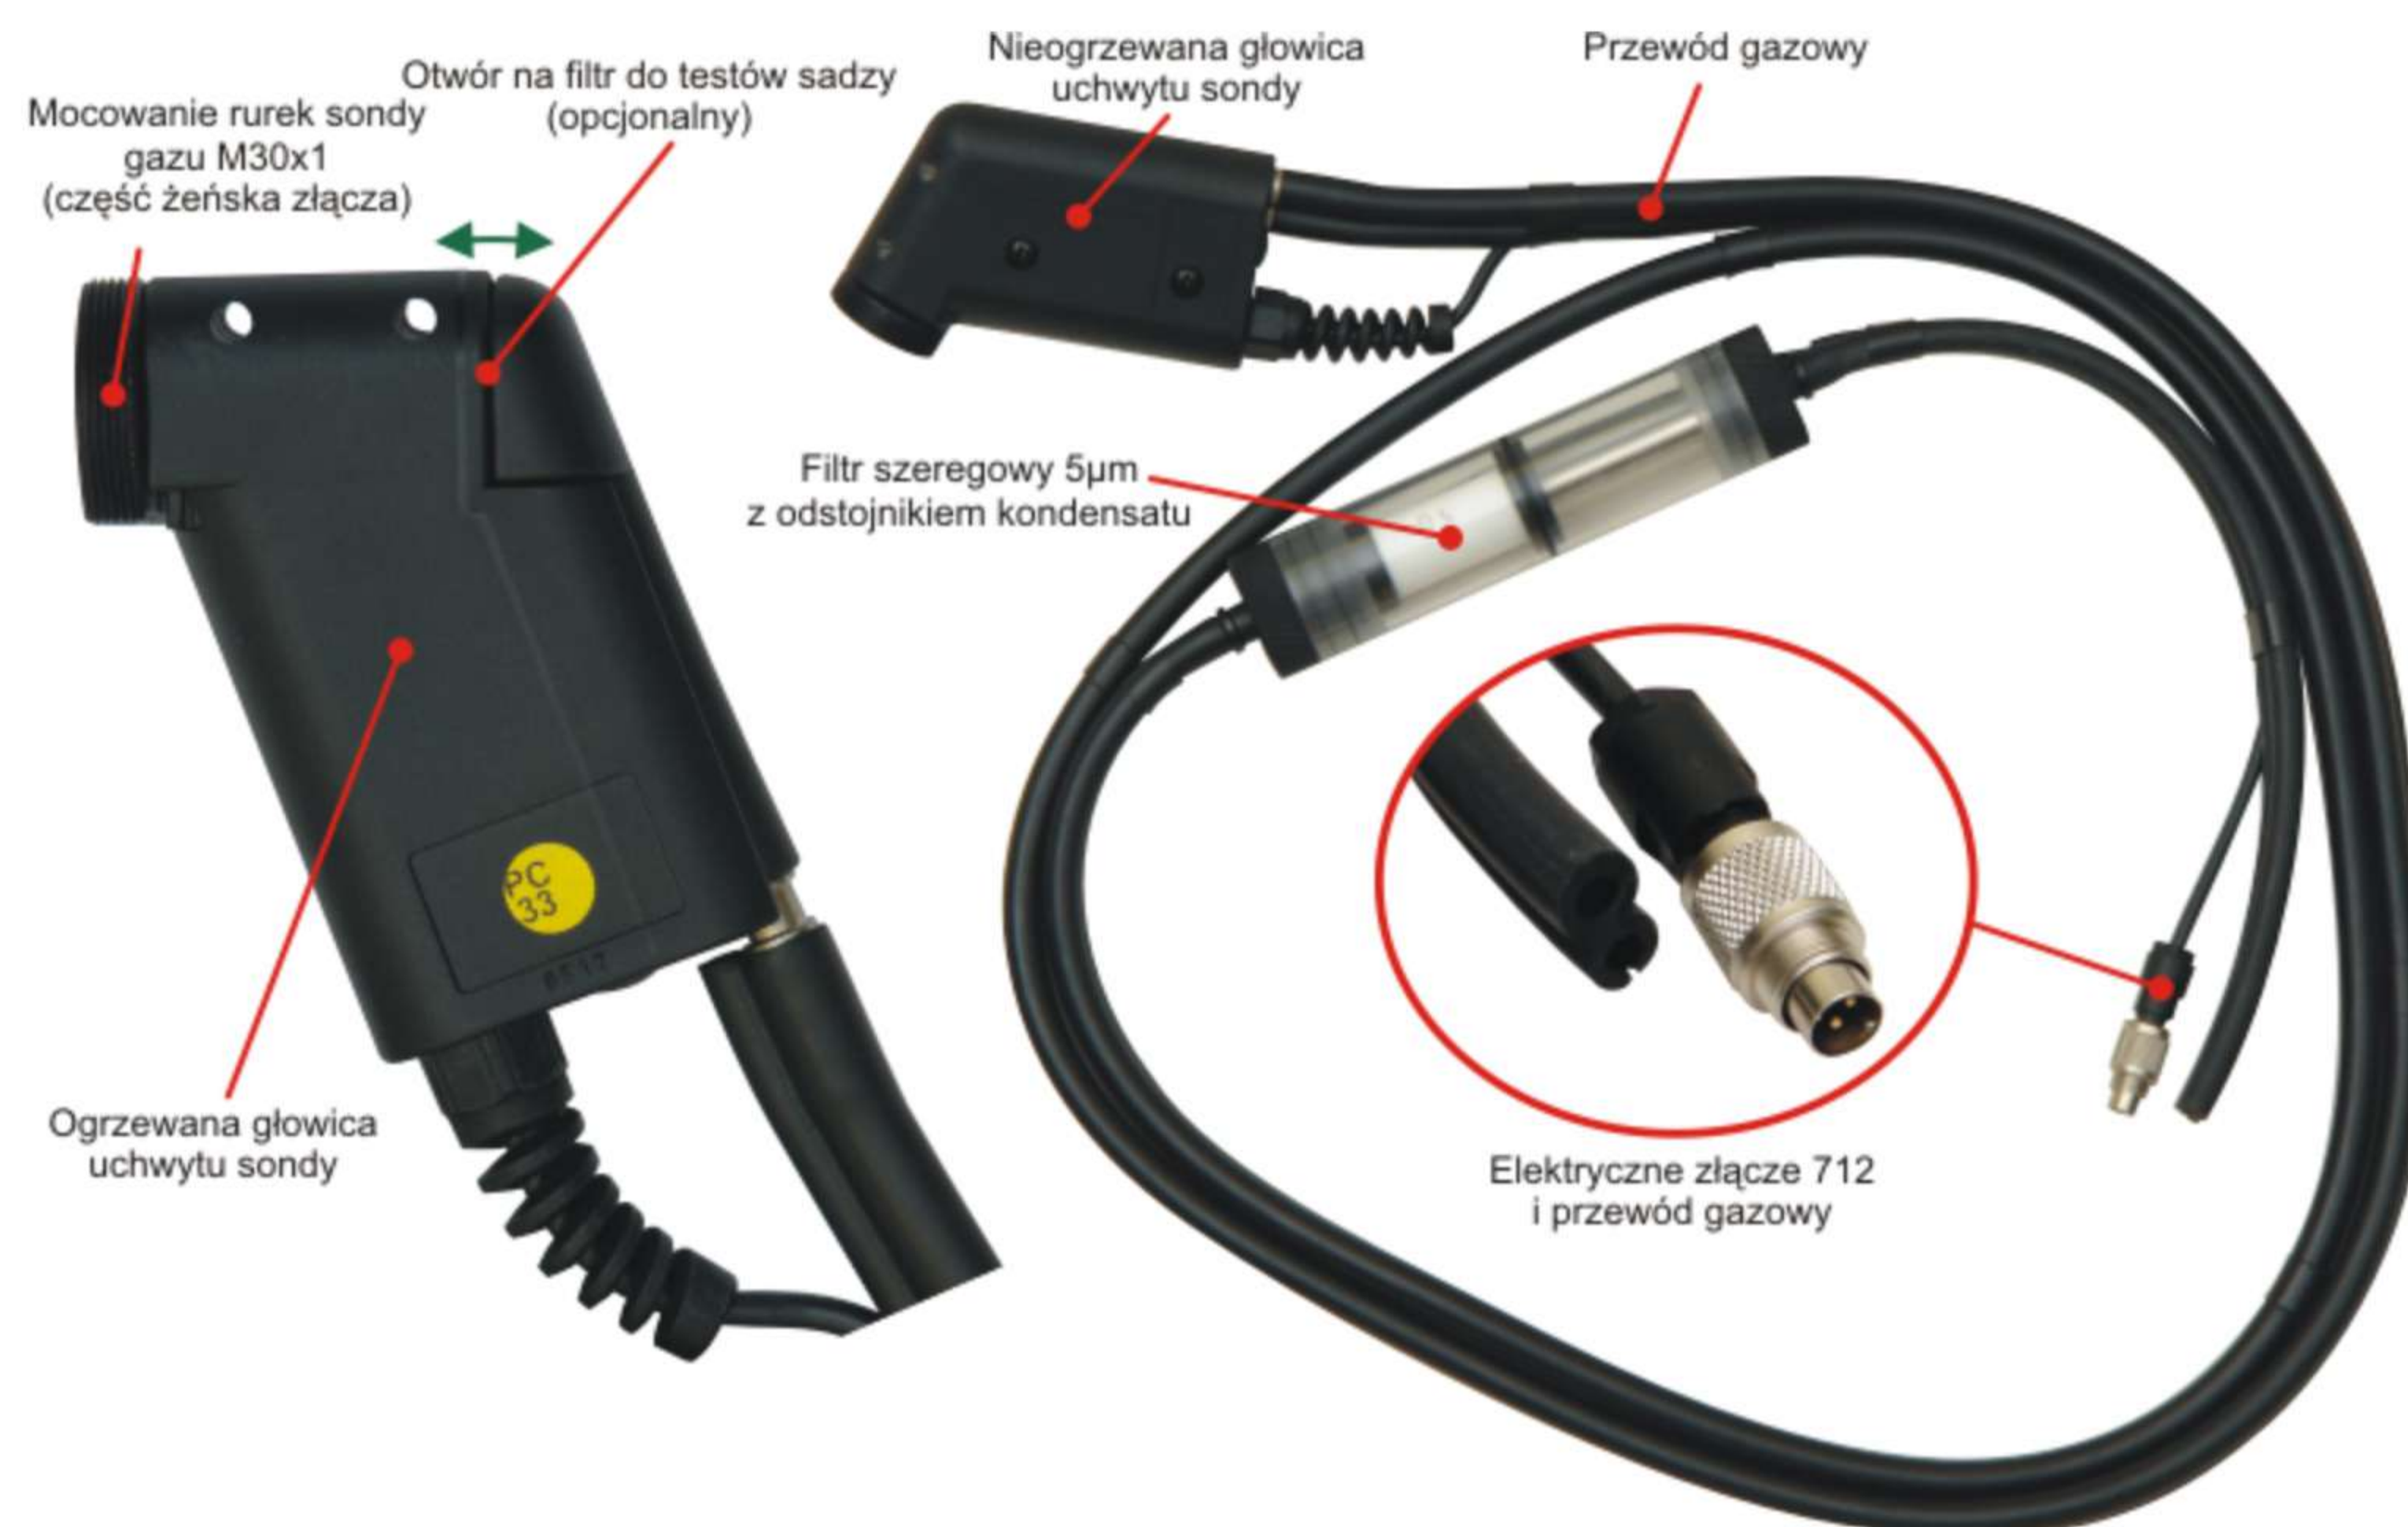

B. Uchwyty sond gazu dla pozostałych urządzeń

Uchwyty sond dla wszystkich analizatorów prócz GA-12^{plus} są wyposażone w grubszy wężyk gazowy (ID=5.0mm) i 7-pinowe złącze elektryczne typu Binder 581. Złącze posiada wbudowany sensor temperatury zewnętrznej PT500. Wężyk gazowy zakończony jest żeńską szybkozłączką ID=8.0mm. W wypadku wystąpienia filtra szeregowego proponuje się użycia wkładki filtrującej o wielkości porów 20µm.

